OSCILLOSCOPE 673

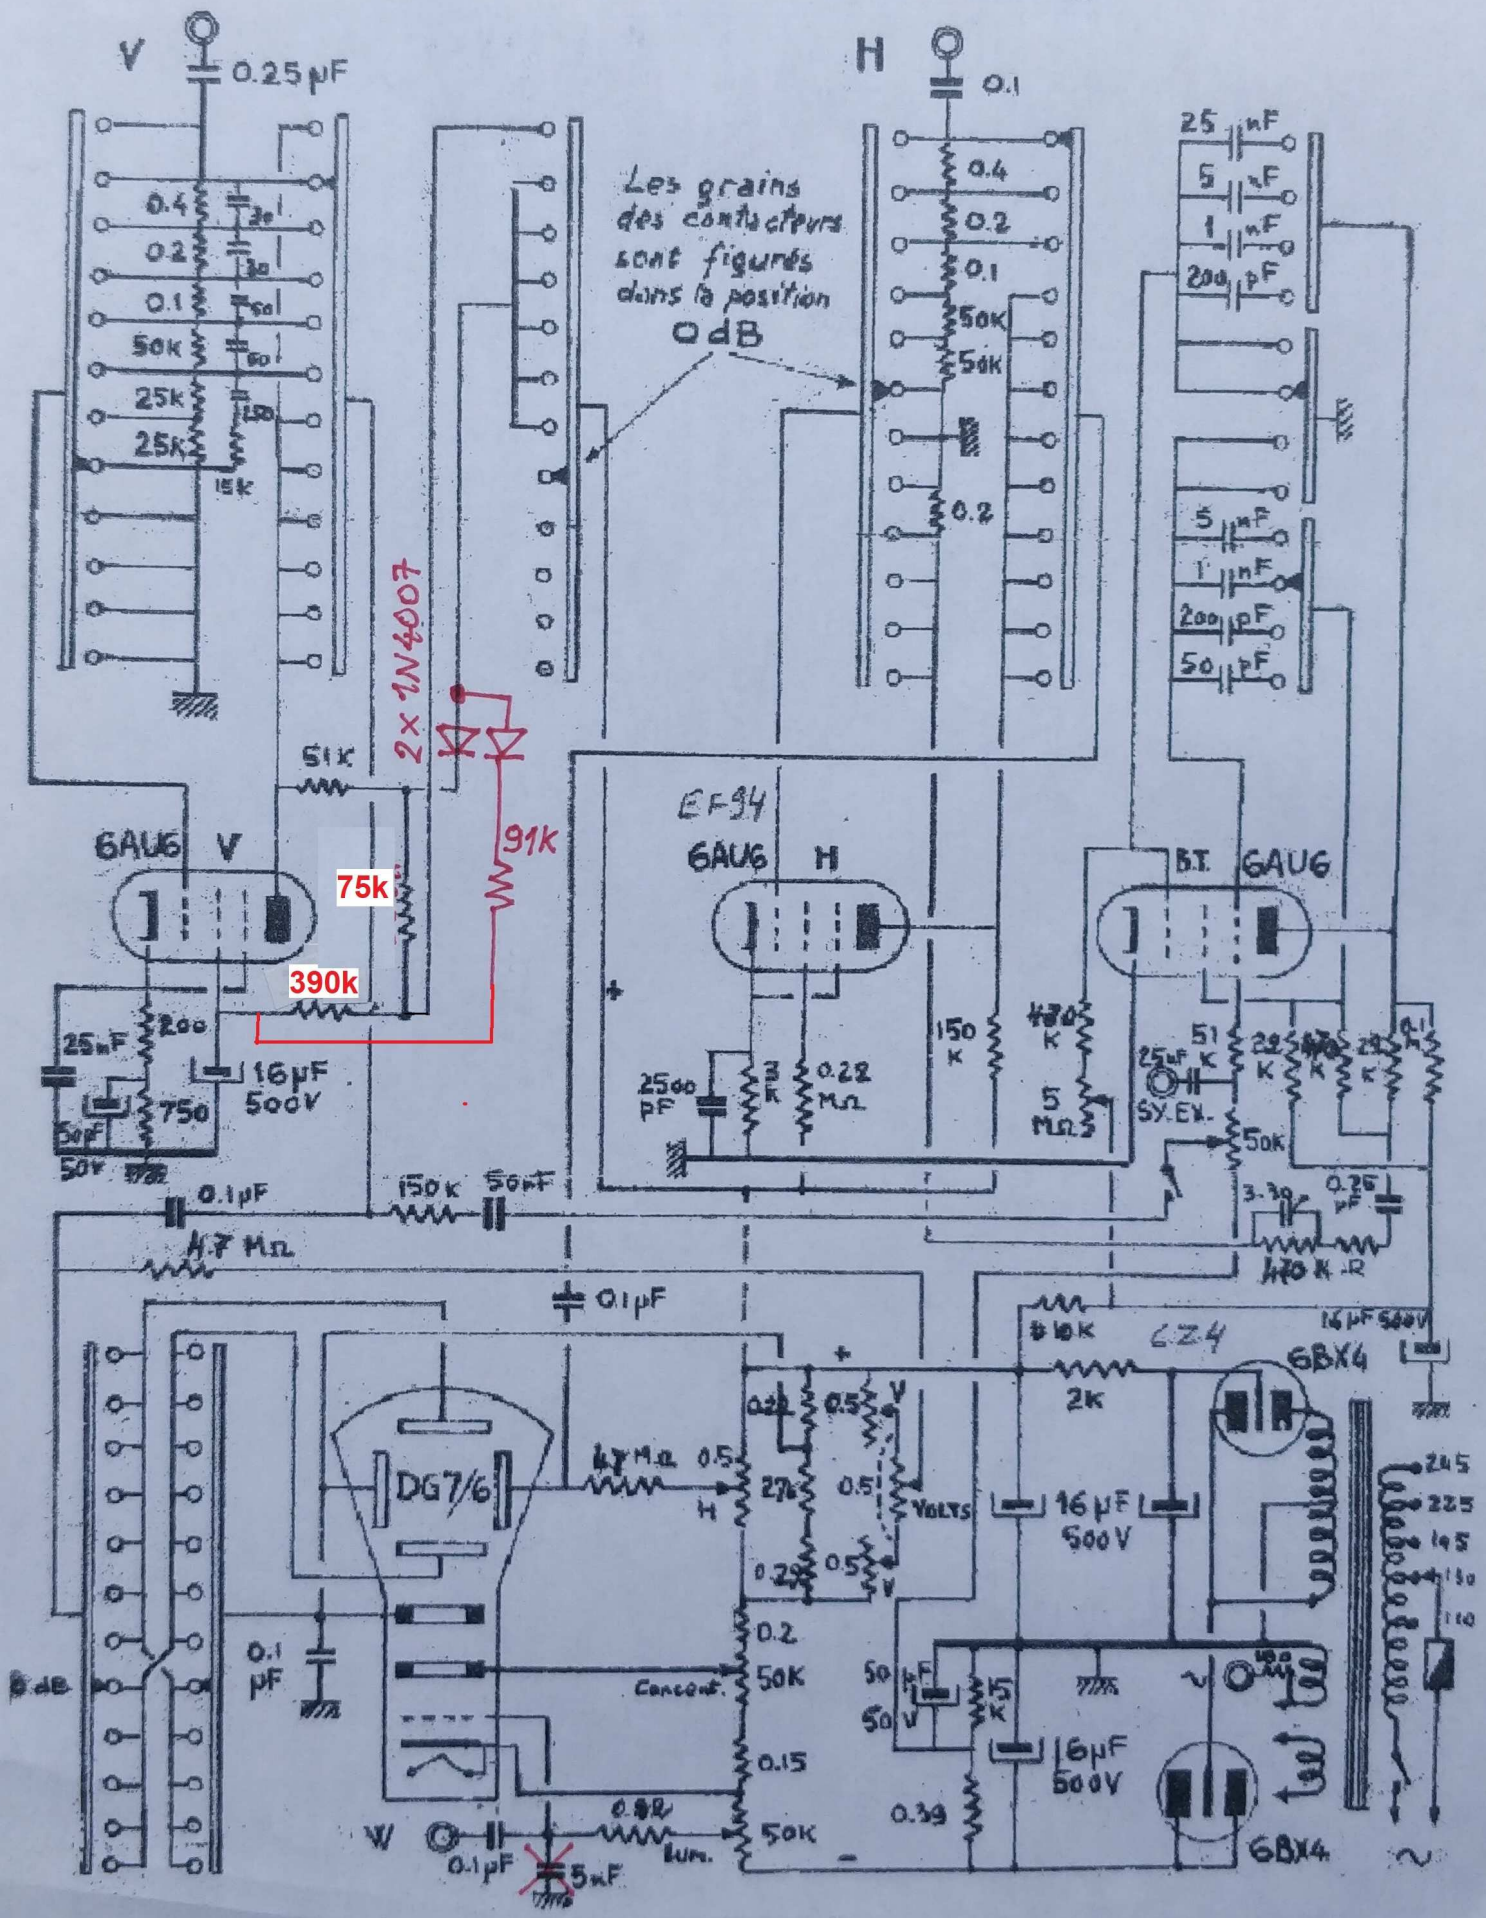

Schéma amélioré le 30/07/2023 par John Peter (jope004)
Raison : déplacement des points de repos de l'ampli vertical pour éviter les saturations.
En position 40dB, la tension d'anode passe de 210V à 130V.
En position 6 à 36dB, la tension d'anode passe de 55 à 130V.
Supression du condensateur de 5nF entre le Whenelt et la masse pour améliorer la bande passante.