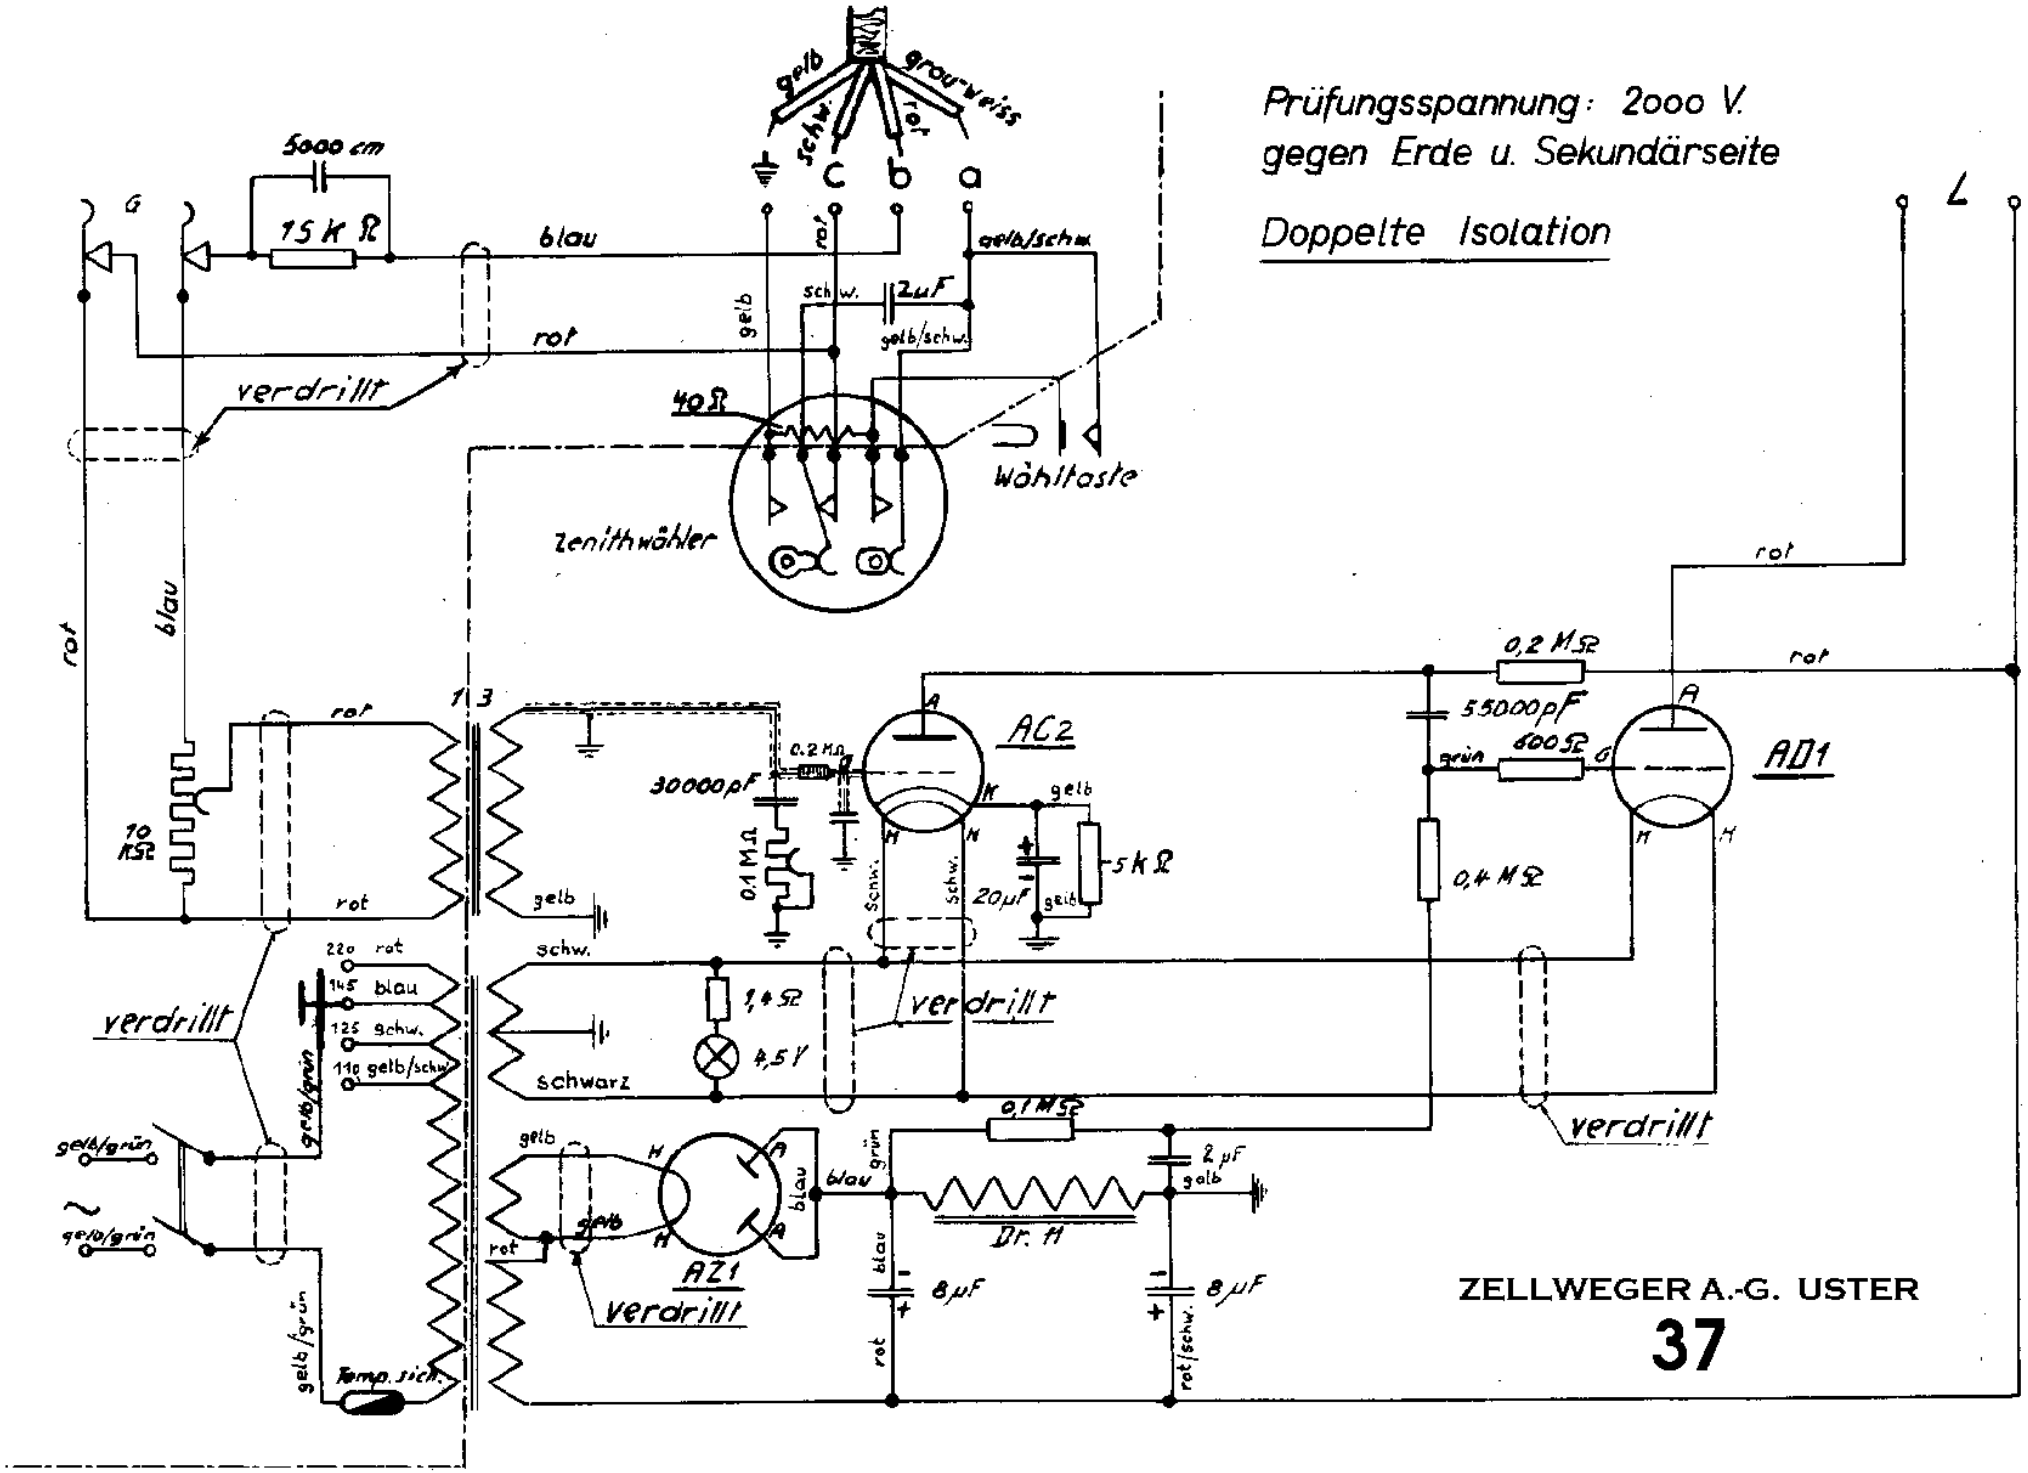
Prüfungsspannung: 2000 V.
gegen Erde u. Sekundärseite
Doppelte Isolation
5000 cm
15 kΩ
blau
rot
verdrillt
40 Ω
Wähltaste
Zenithwähler
gelb
grau-weiss
schw.
rot
c b a
gelb/schw.
2 µF
AC2
AD1
AZ1
30000 pF
0,2 MΩ
0,1 MΩ
5 kΩ
20 µF
55000 pF
600 Ω
0,4 MΩ
0,2 MΩ
0,1 MΩ
1,4 Ω
4,5 V
schwarz
gelb/grün
220
145
125
110
Dr. H
2 µF
8 µF
8 µF
10 kΩ
Temp. sich.
ZELLWEGER A.-G. USTER
37