

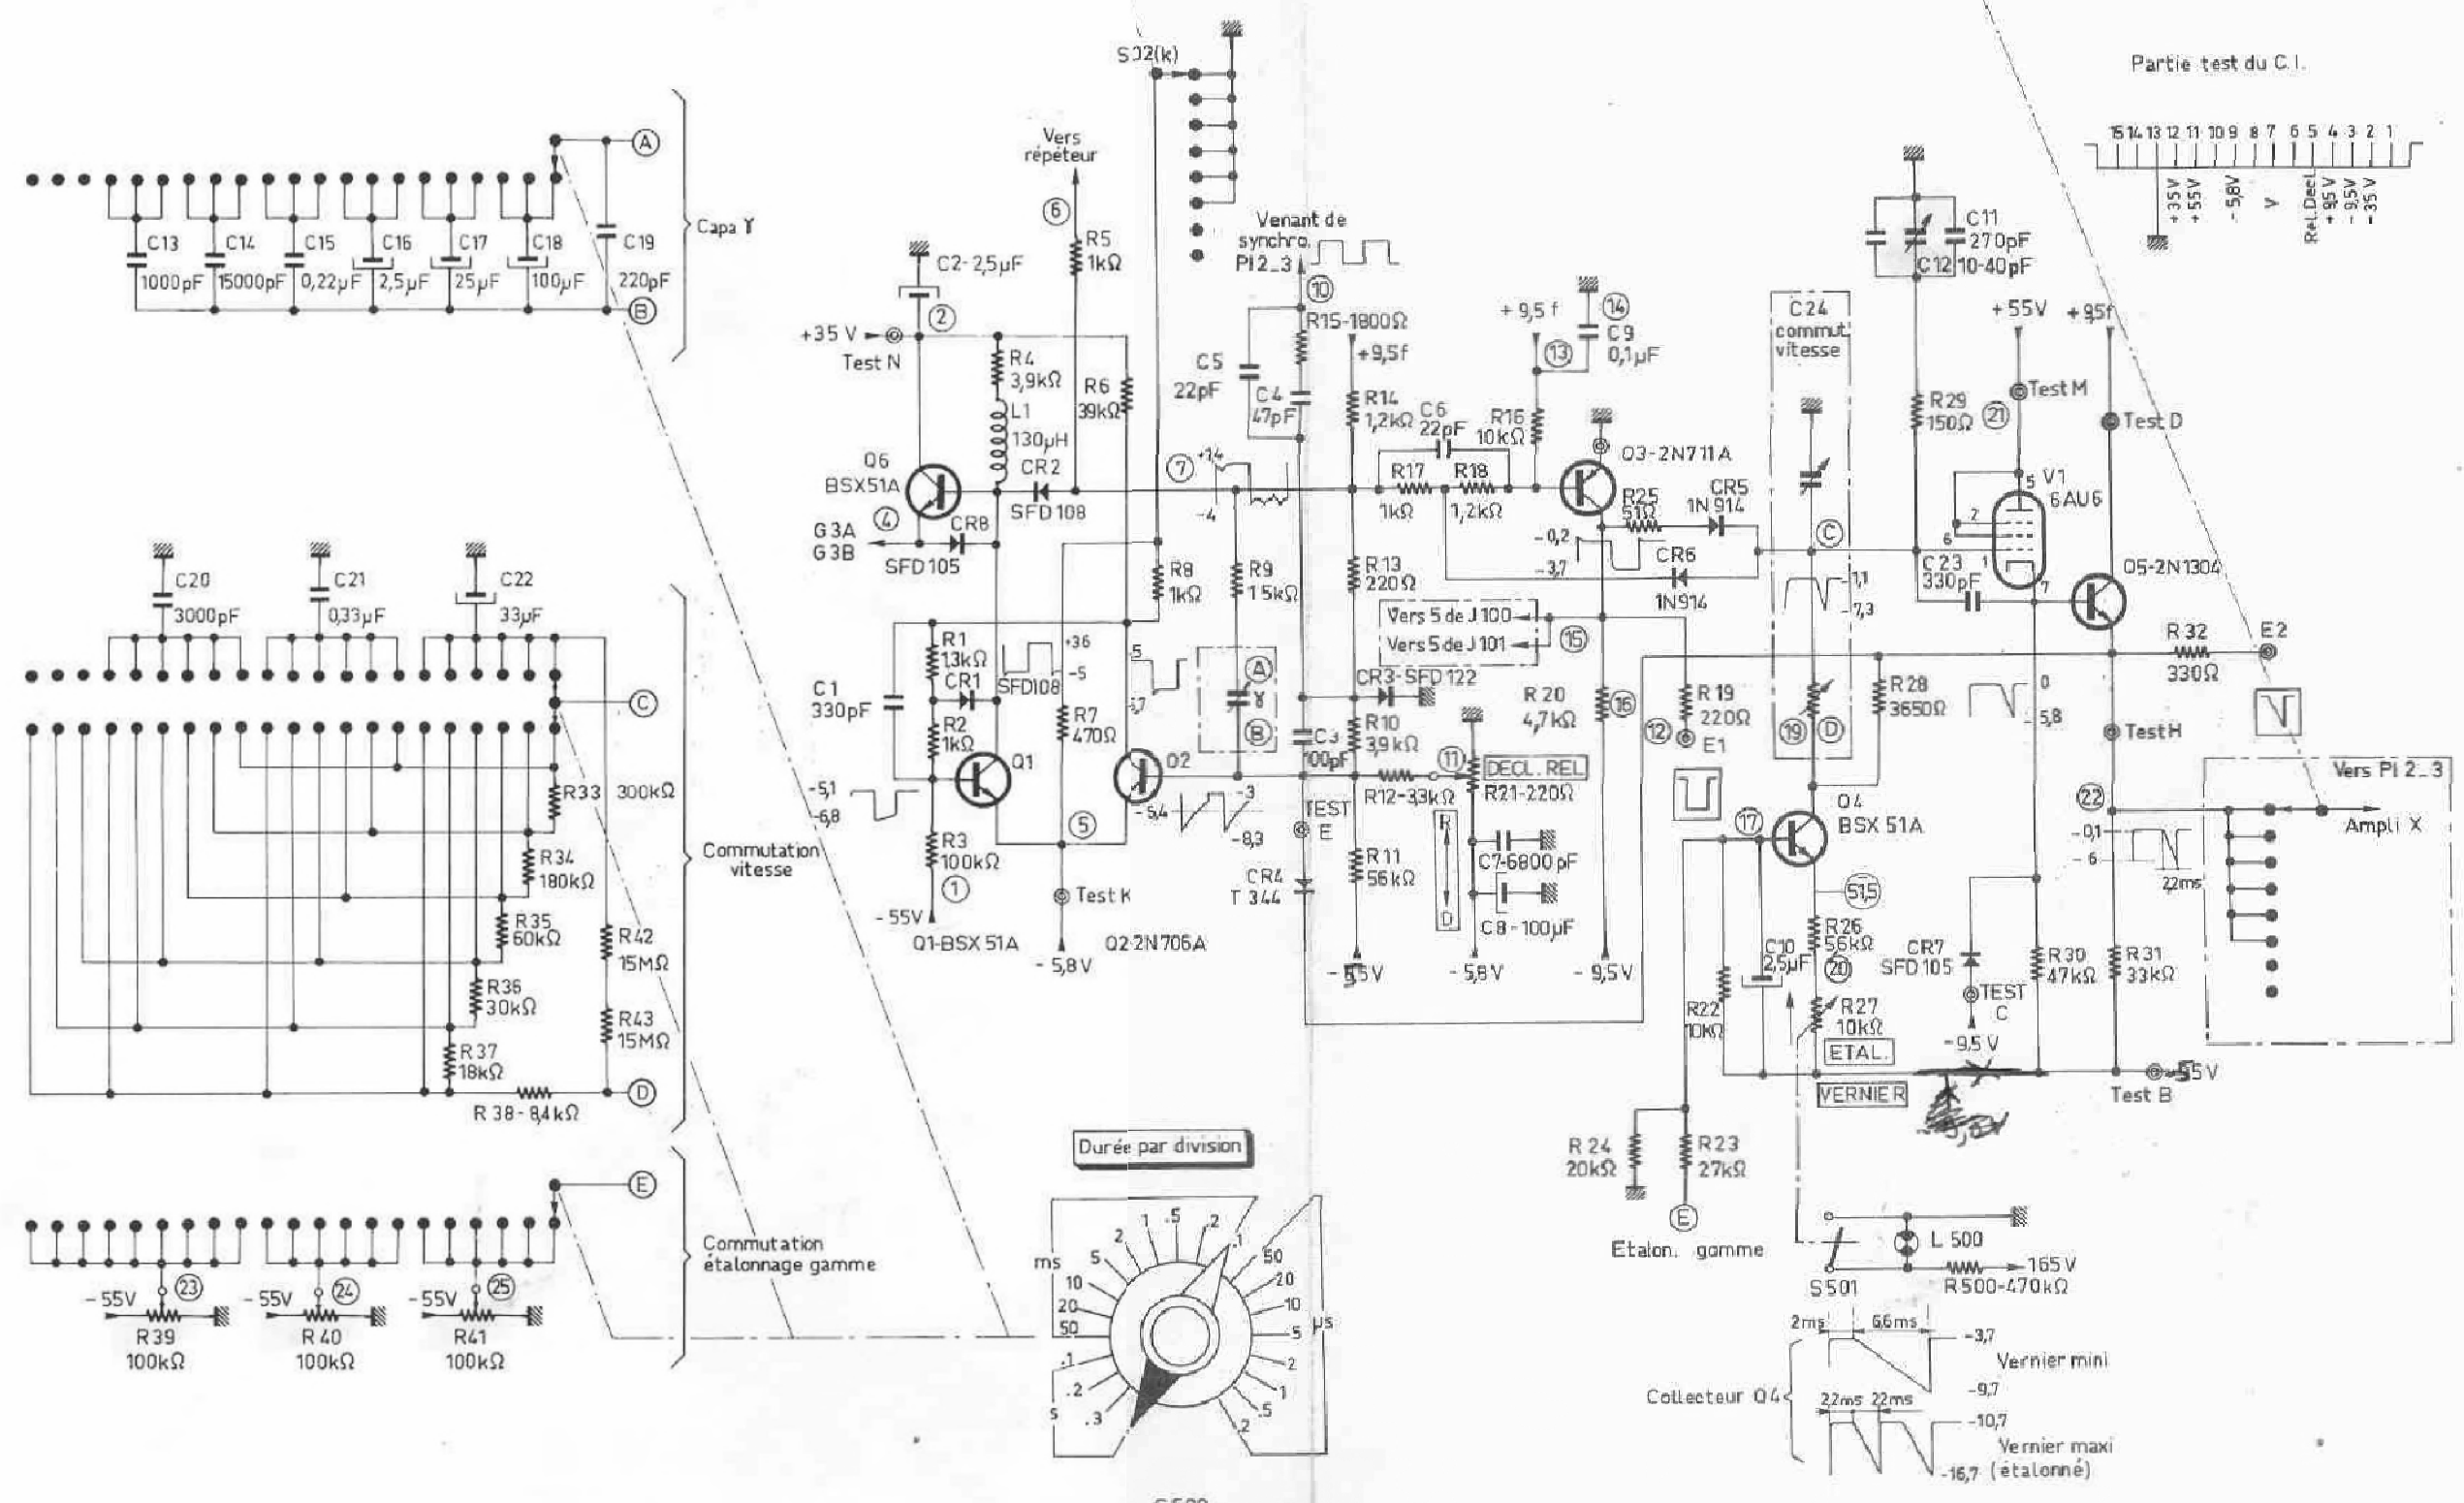




Mesures à l'oscilloscope dans les conditions suivantes:
 -Vitesse 0,2 ms/cm
 -Secteur 50Hz à sa valeur nominale
 -Signal examiné: calibrateur en déclenché
 -Vernier étalonné, sauf indication contraire



Partie test du C.I.



Durée par division



Emetteur Q4: Plage de tension permise par les réglages R39 à R41
 - 30 à - 41V

Planche 2.4 : BASE DE TEMPS