


STEREO

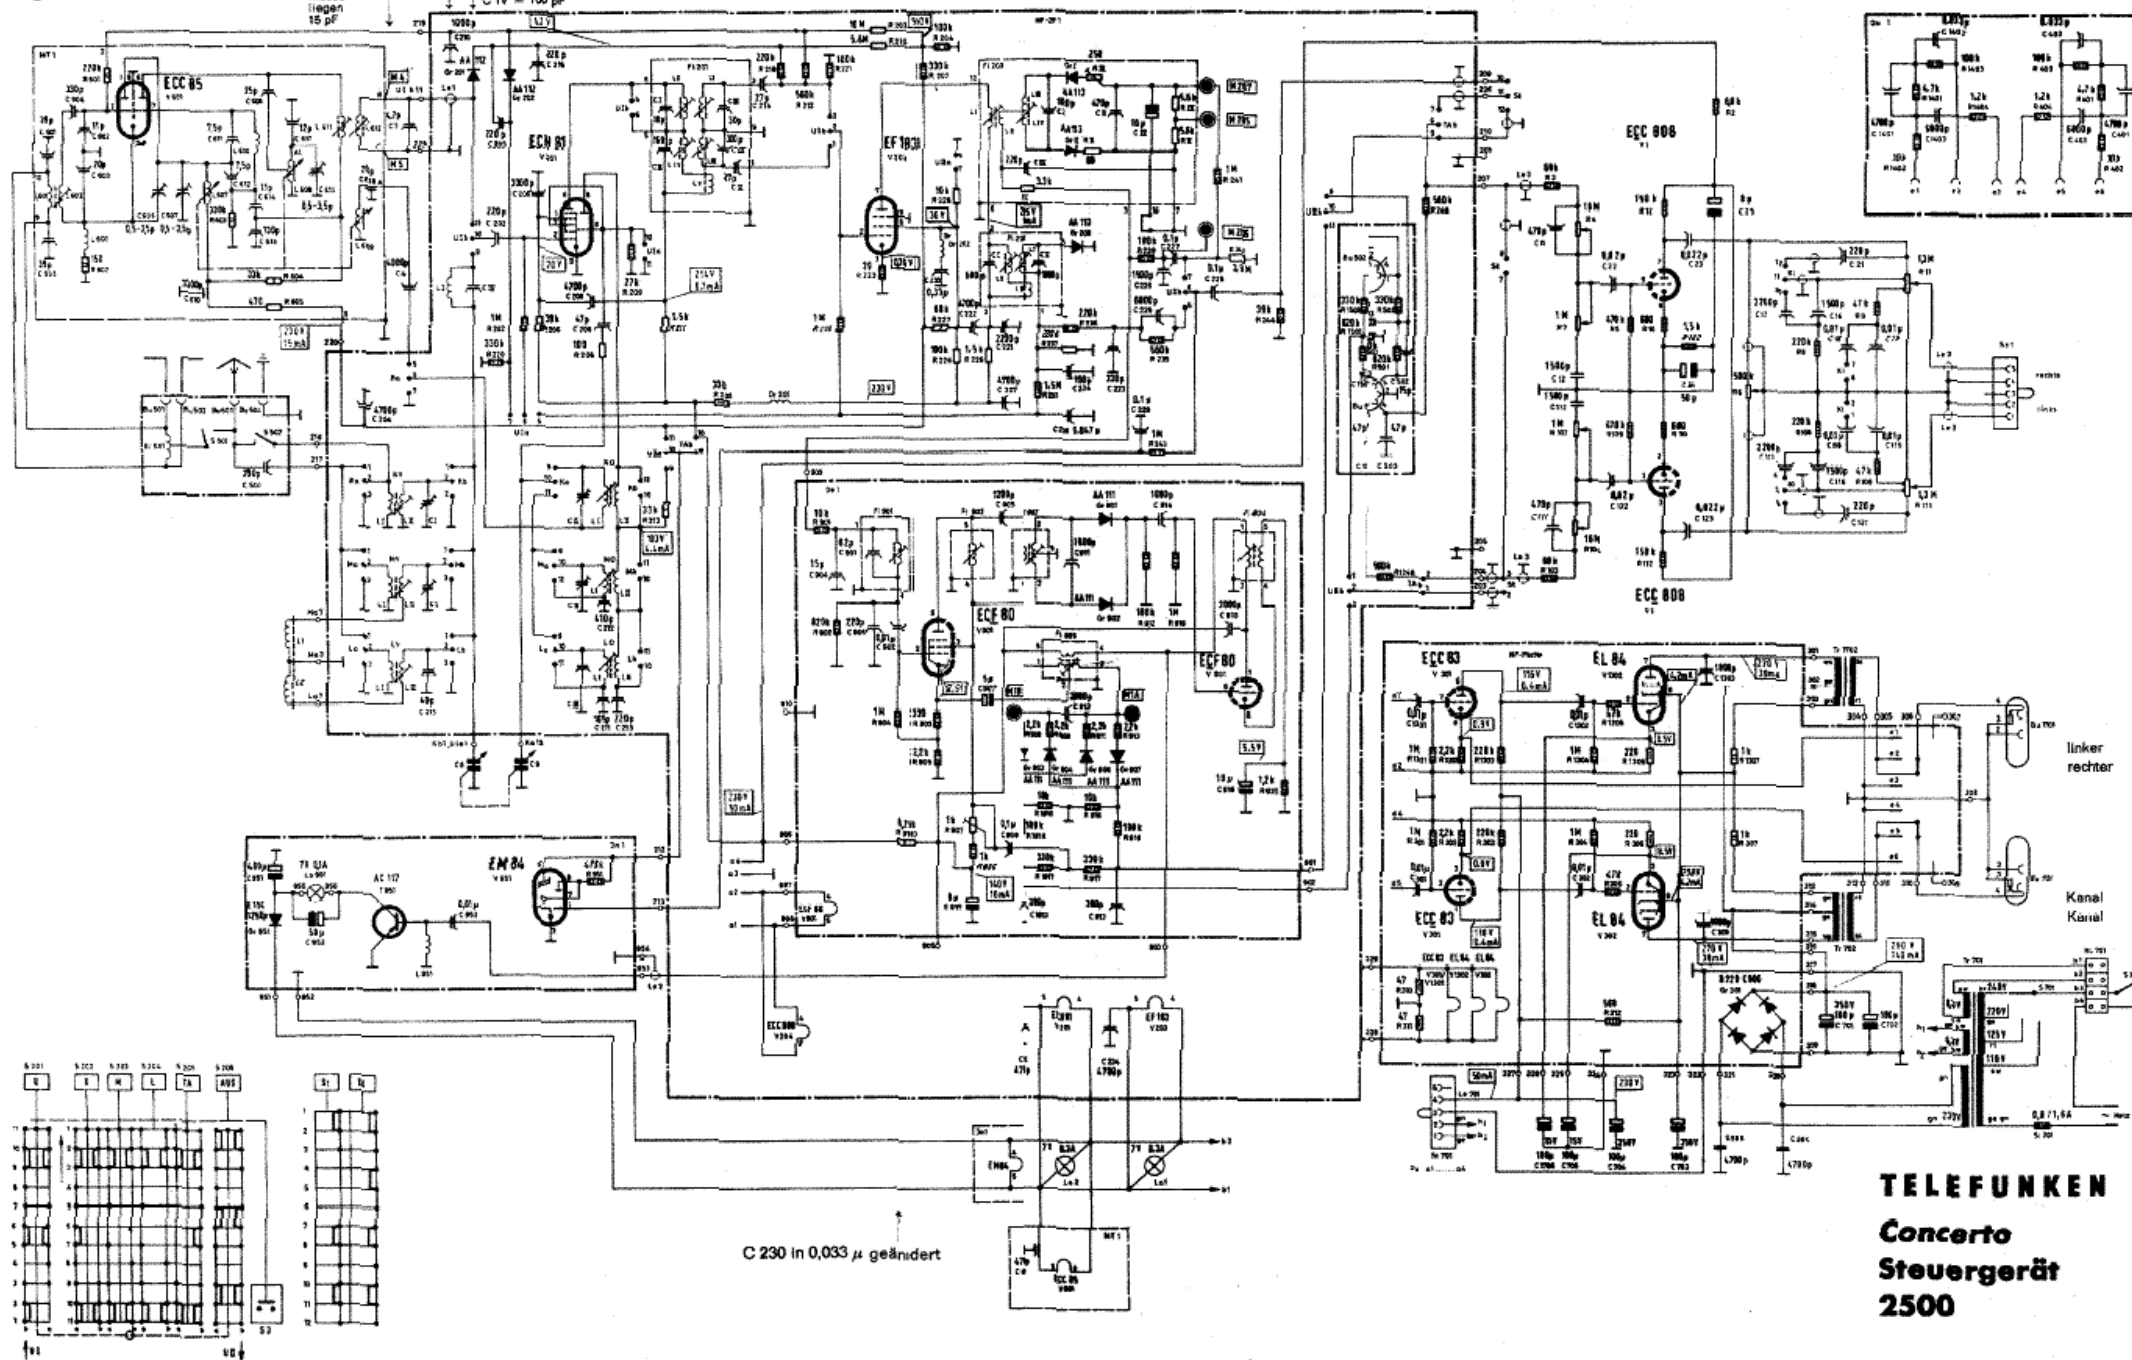

Li
abgleichbar

 $C_{IV} = 100 \text{ pF}$ 

C 230 in 0,033 μ geändert

TELEFUNKEN
Concerto
Steuergerät
2500