


# SBR 637 A

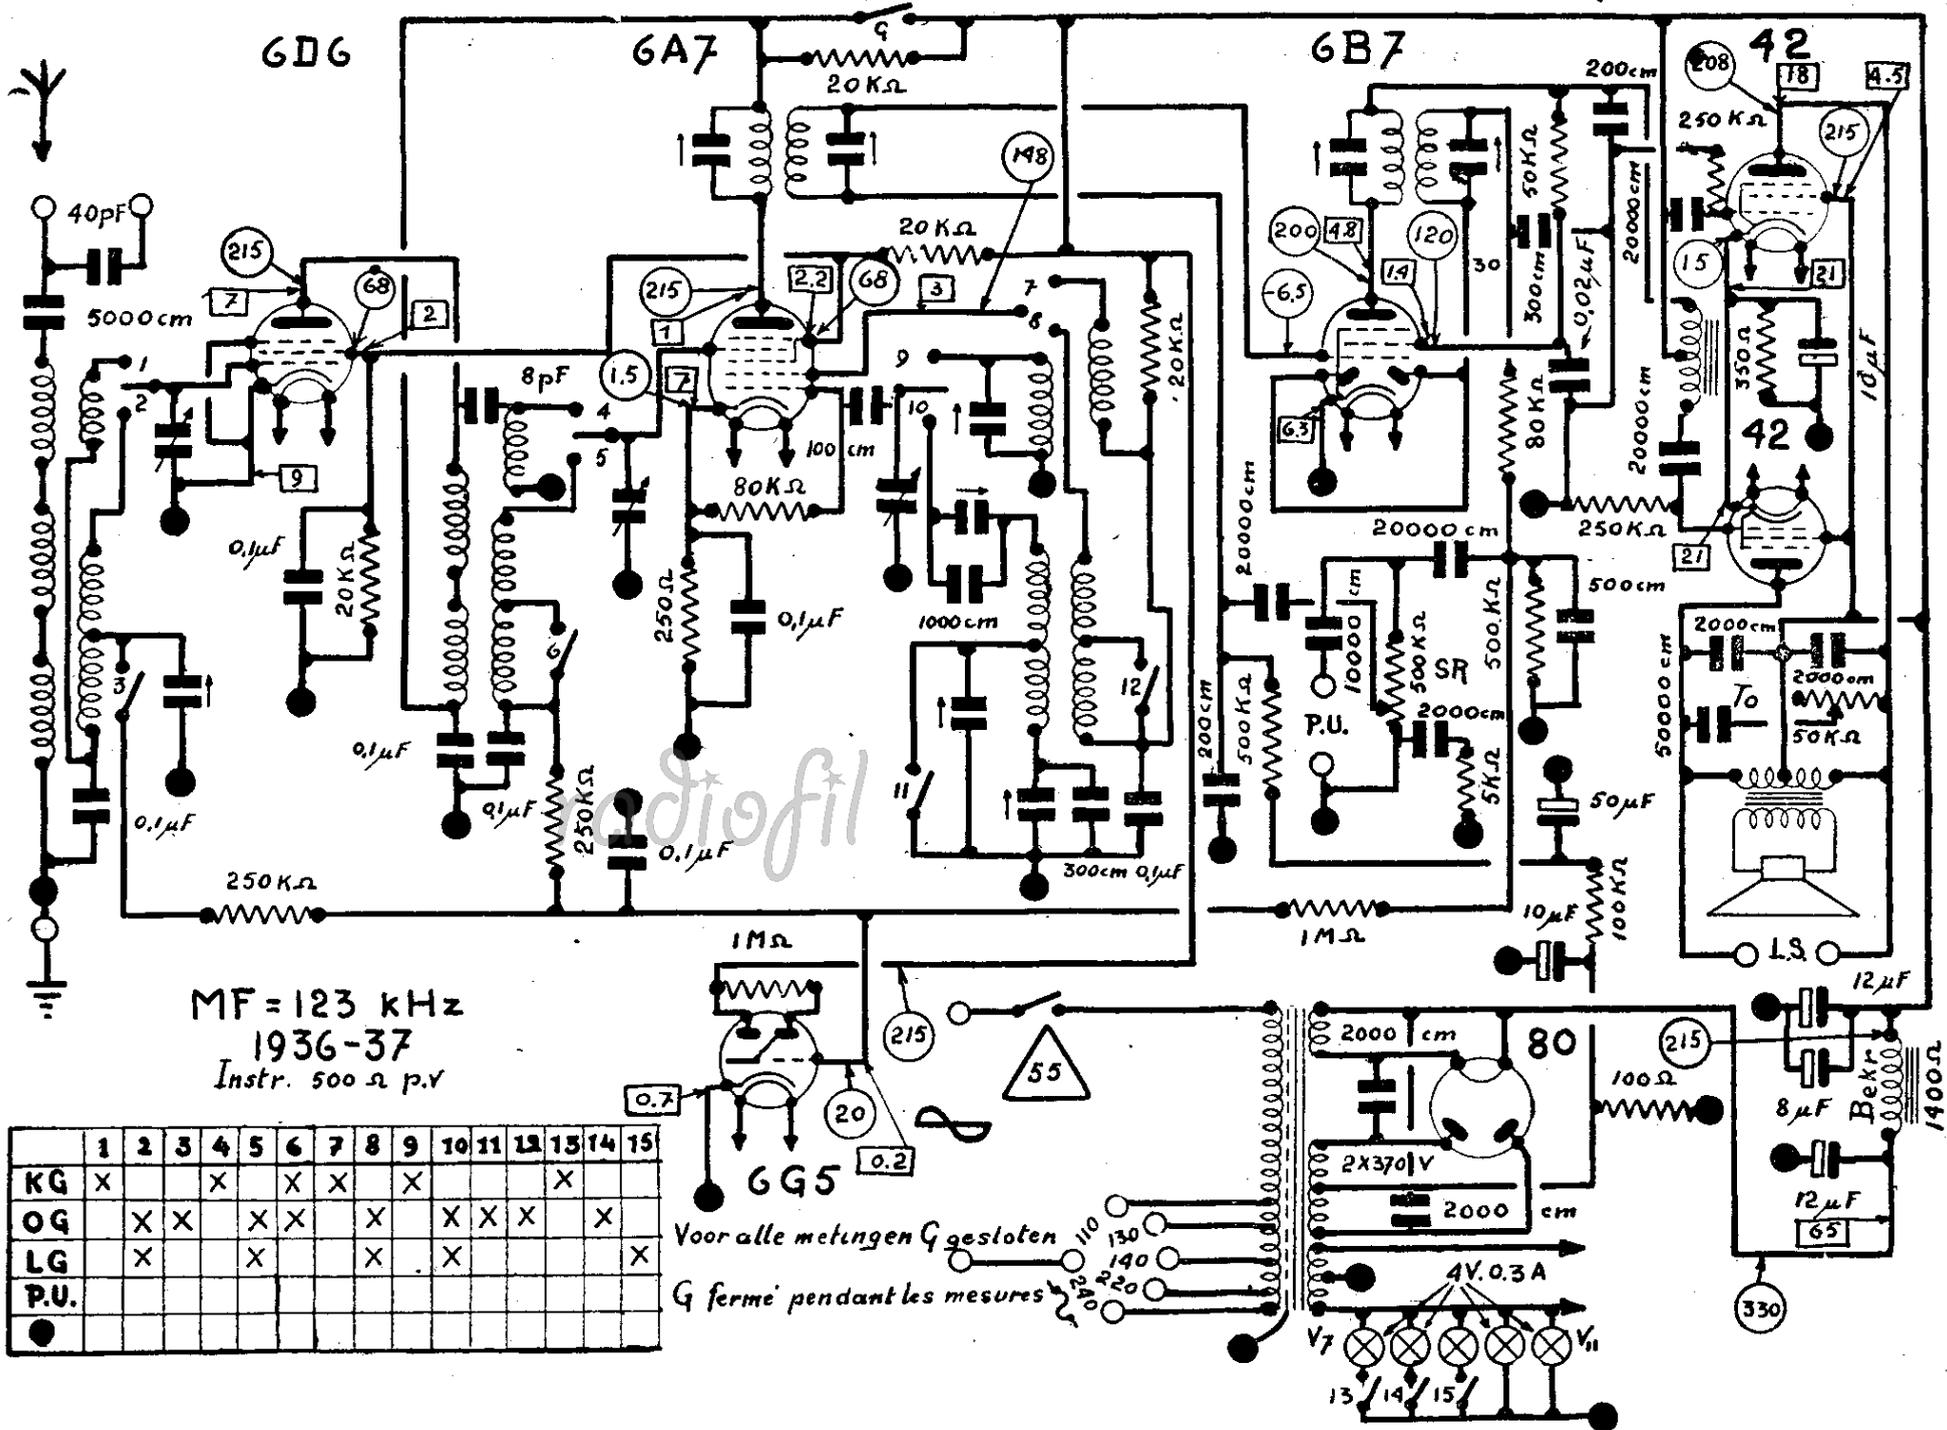

MF = 123 kHz  
1936-37  
Instr. 500 Ω p.v

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KG	X			X		X	X		X						X
OG		X	X		X	X		X		X	X	X			X
LG		X			X			X		X					X
P.U.															

Voor alle metingen G gesloten  
G fermé pendant les mesures